

Description of this Thermometer

EN

- ① ON/OFF button
- ② Display
- ③ Battery compartment cover (back side)
- ④ Measuring sensor / measuring tip
- ⑤ Cleaning and disinfecting area (thermometer probe only)


Important Safety Instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!
- Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section.
- Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.
- Protect the device from impact and dropping!
- Avoid bending the thermometer probe more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section to clean the device to avoid damage to the device.
- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local Microlife Service to arrange the test.

WARNING: The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.

Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.



Type BF applied part

Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ①; a short beep signals "thermometer ON". A display test is performed. All segments should be displayed. The last measurement reading will be shown on the display ② automatically for 2 seconds with the «M» icon.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «C» appear at the display field ②. The thermometer is now ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «C» is no longer flashing, the end-temperature has been determined and the thermometer can be read now.

Short beeps will sound when the temperature is higher than 37.5 °C in order to alert the patient that he/she may have fever. Reference: Oral temperature.

To achieve comparable results allow a 1 minute interval time between measurements.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ①. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Reviewing the last measurement

When turning on the thermometer, the last measurement will be displayed with a «M» for memory.

Measuring methods / Normal body temperature

In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C

Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor ④ under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading.

Because the axillary takes more time to reach its stable temperature wait at least 5 minutes, regardless of the beep sound.

In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C

Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ④ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

Approx. measuring time: 10 seconds!

In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C

Carefully insert the measuring sensor ④ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended.

If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

Approx. measuring time: 10 seconds!

Cleaning and disinfecting

Before and after each use, clean the thermometer probe ⑤ with lukewarm soapy water. Wipe dry with a clean soft tissue.



WARNING: Det erhållna mätresultatet som erhållits med detta instrument är ej en diagnos! Lita ej endast på mätresultatet.

Batterier och elektroniska instrument ska avfallshanteras enligt gällande miljölagstiftning. Släng inte i hushållssoporna.

Läs dessa instruktioner noga innan du använder instrumentet.

Tillämpningsklass BF

Starta termometern

- Tryck på PA/AV-knappen ① för att starta termometern, ett kort bipjuder «termometer PA». Ett test utförs på bildskärmen. Alla segment ska visas.
- Senaste mätning visas i displayen ② automatiskt i 2 sekunder med ikonen «M».
- Vid en omgivningstemperatur under 32 °C visas ett «L» och ett blinkeende «C» på bildskärmen ②. Termometern är nu klar att användas.

Funktionstest

- Termometern funktionskontrolleras automatiskt varje gång den startas. Om ett fel uppkommer (mätfeil) visas detta med «ERR» på bildskärmen och mätning kan inte utföras. Termometern kan i detta fall inte användas och måste ersättas.

Användning av termometern

- Väl den mätningstiden du vill ha. Under en mätning visas den aktuella temperaturen i displayen hela tiden och symbolen «C» blinkar. När ett bipjud ① hörs gör och «C» slutar blinka, det slutvärdet har fastställts och resultatet kan utläsas.

- För professional use, immermättar thermometeren ⑤ i to Isopropyl (70%) för at least 5 minutes (max. 24 hours).

- Låt den disinfekta dryt ut till thermometeren är completely dry. Apply probe covers (available as accessory) in the professional environment.

- Other cleaning agents or cleaning methods may cause malfunction or damage to the product and will void the warranty.

- Consider the application and safety instruction of the disinfectant manufacturer.

- Avoid wiping and immersion of the display area to protect it from fading.

- Do not boil, clean in dishwasher or clean in autoclave units.

- Do not use in highly sensitive care units where a higher level of disinfection is advised (ICU, Oncology...).

Battery Replacement

- When the «▼» symbol (upside-down triangle) appears in the display, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover ③ from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

Technical Specifications

- Type: Maximum thermometer
Measurement range: 32.0 °C to 43.9 °C
Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)
Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)

- Measurement accuracy: ± 0.1 °C; 34 - 42 °C
Operating conditions: 10 - 40 °C; 15 - 95 % relative maximum humidity
Storage conditions: -25 - 60 °C; 15 - 95 % relative maximum humidity

- Mättid cirka 10 sekunder!

- Varning! Tämän laitteen antama mittaustulos ei ole diagnoosi. Älä luota vain mittaukkoon.

- Pistol och elektroniskt laitteen tyyppi ja vähintään 3.3 m

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.


- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi ihon lämpötilan mittaamiseen.

- Varoitus! Tämä la

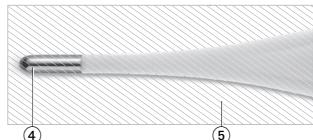

Termometra apraksts

- ① Poga ON/OFF (LESLEGIT/ZSLEGT)
② displejs
③ Bateriju nodalījuma apvāks (aizmugurē)
④ Mērišanas sensors/mērišanas uzgals
⑤ Tīršanas un dezinfekcijas zona (tik termometra zondei)

Svarīgi drošības norādījumi

- Sekojiet lietošanas instrukciju. Šajā dokumentā ir sniegtās svarīgas informācijas par produkta ekspluatāciju un tā drošības noteikumiem. Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu un saglabājiet to turpmākai lietošanai.
- Šī ierīce ir lietošanas tikai cilvēku kermēna temperatūras mērišanai muti, taisnājā zarnā vai padusē. Nemēģiniet mērit temperatūru cietais vēdas, piemēram, asti, ja vos radit viltus rādumus un var radīt traumas.
- Nelietojiet šī ierīci, ja domājat, ka tā ir bojāta, vai pamānat kaut koparējus.
- Pirms pirmās lietošanas personiskajai higiēnai mēs iesakām šo ierīci iztīt saskārn ar tīršanas instrukciju.
- Minimālais mērišanas tilks ir jāievēro bez izņēmumiem līdz skajās signāliem izdzīrēšanai!
- Nemēģiniet vērtēt, ka var būt pieciešams turpināt mērišanu pat pēc pīkstena, skafītā sadāju.
- Nemēģiniet veikt taisnās zarnas mērišanu cīlvēkiem ar taisnās zarnas traucējumiem. Sāda rībā var saasināt vai paslīnīt traucējumus.
- Pārliecīties, ka bērni neizmanto šī ierīci bez uzraudzības! Dazās šīs zondas ir pieteikami sīkas, lai tās varētu rādīt.
- Neizmantojiet instrumentu tuvu specifiskiem elektromagnētiskiem laukumiem, piemēram, mobilajiem telefoniem un radiouztvērējiem. Lielojojiet šo ierīci, ievērot minimāli 3 cm attālumu līdz sādām ierīcēm.
- Instrumentu nemest zemē un pasargāt pret triecienviņiem!
- Nesaliecit termometru zondi virāt ar 45°!
- Izvairieties no situācijas, kad apkārtējās dēļas temperatūra pārsniež 60 °C. NEKAD nevirāt izstrādājumā!
- Lai izvairītos no ierīces bojājumiem tīršanas laikā, tīršanai izmantojiet tikai to komerciālos dezinfekcijas līdzekļus, kas norādīti sadājā.
- Leteicības iekārtas nevarētu gadīties vācībām ar tāmējību, ja tāmējība ir īstākās pārākstība. Ierīces precizitāti. Lai veiktu pārbaudi, lūzu, sazinieties ar vietējo Microfife-servisu.

UZMANIŪS! Šīs ierīces parādītās mērišuma rezultāti nav diagnozi! Neplašajiet tās vienīgi uz mērišuma rezultātu.

Baterijas un elektronikas izstrādājumi ir jālīkvidē saskārā ar vietējo likumdošanu, nevis jāzmet sadzīves atkritumos.

Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet norādījumus.

Aizsardzības klase: BF

Termometra iestēgšana

Lai iestēgtu termometru, nospiediet ON/OFF pogu ①; tās skanas signāls signalizē, ka "termometrs ir iestēgts". Tieki veiks displeja tests. Jāzārāda visi segmenti.

Pēdējais mērišuma noslēgums 2 sekundes automātiski tiek parādīts displejā ② ar «M» simbolu.

Pēc tam, ja apkārtējās dēļas temperatūra ir zemāka par 32 °C, displeja laicīnā ② tiek parādīts «L» un mirgojošs «C». Tagad termometrs ir gatavs lietošanai.

Funkcijonēšanas tests

Termometra pareiza funkcijonēšana tiek automātiski pārbaudīta katru reizi, kad termometrs tiek iestēgts. Tieki atkārtoti nepareiza darbību (mērišanas neprecizitāti), displejā parādās pazīmējums «ERR» un mērišanu svārstību iestējumi. Sāda gadījumā termometrs ir jāmaina.

Termometra lietošana

Izvēlieties nepieciešamo mērišuma metodi. Veicot mērišanu, displejā tiek parādīta pašreizējā temperatūra un «C» simbols mirgo. Mērišuma beigas apstiprina skāns, kas atsāk mērišanu 3 reizes, simbols «C» vairs nemirgo. Kermēna temperatūra ir noteikta. Mērišuma rezultāts tiek parādīts displejā.

10. Šajās skānas signāliem atskānes, ja temperatūra ir augstāka par 37.5 °C, tā būtībā pacientu, ka vīnā/vīgā varētu būt drūdzis. Atsaucies: Temperatūra, mērot mutē.

Lai iegūtu salīdzināšanas rezultātus, veiciet atkārtotu mērišumu pēc 1 minūtes intervāla.

Lai pagarinātu baterijas kalpošanas ilgumu, izslēdziet termometru, ja nospiežiet ON/OFF pogu ①. Pretējā gadījumā termometrs automātiski izslēgsies pēc 10 minūtiem.

Pēdējā mērišuma caurskatīšana

Lešķēdot termometru, pēdējais mērišums tiek parādīts ar «M» atzīmētu simbolu.

Mērišanas metodēs / Normāla kermēna temperatūra

► Padusē / 34.7 - 37.3 °C

Noslaukumi padusi ar savu dvieli. Novietojiet mērišanas sensoru ④ padusēs centrālā tālā, lai pīkstekās ādai, un novietojiet pacienta rokā plakus pacienta kermēnā. Tas nodrošina to, ka telpas gāzi neietiek mērišumā. Tā kā padusi pieciešams (mērišanas neprecizitāti), displejā parādās pazīmējums «ERR» un mērišanu svārstību iestējumi. Ja tas neiespējams, iestējumi.

► Mērišana (orāli) / 35.5 - 37.5 °C

10 minūtes pirms mērišanu nedzēt un nedzēt neko karstu vai aukstu. Muti jāpaliek aizvērtā līdz 2 minūtiem pirms mērišanas sākuma.

Novietojiet termometru vienā no dienviduorientētām zīmēm — labi vai pa kreisi no mīles saknes. Mērišanas sensoru ④ ir jābūt saskārā ar audēnu. Alzīveri muti un vienmērīgi elpojiet caur degunu, lai novērtu ielopītu/zelpītu/gaisa ķēlētu uz mērišumu. Ja tas neiespējams izsprūsto elpojiet ādā, jāzīmanto citā mērišanas metodi.

Aptuvēnās mērišanas ilgums: 10 sek.

► Analājā atvērā (taisnājā zarnā) / 36.6 - 38.0 °C

Uzmanīgi ievadiet termometru mērišanas sensoru ④ 2-3 cm analājā atvērā.

Leteicības izmantot zondes vācu un smērvīlu.

Ja neesat pārliecināts par mērišanas metodi, sazinieties ar speciālistu, lai saņemtu norādījumus/apmācību.

Aptuvēnās mērišanas ilgums: 10 sek.

Tīršana un dezinfekcijā

Pirms pēc katra lietošanas reizes norītēt termometru zondi ⑤ ar remdu zīmējumiem. Noslaukumi saurus arī mīksto salveti.

Lietošanai mērišanas līdzekļi ir jāuzņem pirms lietošanas, ja vien mērišanas rezultāti ir jāuzņem pirms lietošanas.

Professionālai lietošanai leģendējiet termometru zondi ⑤ izpilāpā (70%) vismaz 5 minūtes (ne varāk kā 24 stundas).

Lai jūtētu dezinfekcijas līdzekļi nozīmē, līdz termometris ir pilnīgi izdzīvījis. Professionālajā vide uzzīciet zondes pārvalkās (pieejami kā piedēriems).

Citi tīršanas līdzekļi vai tīršanas metodes var izraisa produktu darbības traucējumus vai bojājumus un anulēt garantiju.

Sekojiet dezinfekcijas līdzekļa rāzojātā lietošanas un drošības instrukcijām.

Izvairieties no displeja zonas noslaučīšanas un iegremdešanas, lai pasārtotu to izbalzēšanas.

Nevarīgi, netrīni trauku mazgājāmā mašīnā un netrīni auto-klavā bloks.

Nelietojiet tāpiji jūtīgus aprūpes nodalās, kur ieteicama augstāka līmena dezinfekcija (intensīvs terapijas nodala, onkoloģija...).

Kāp naudotis termometru

Pasiņķītē mērišuma metoda, viņa mērišanu laikā ekranā rodās dažādi temperatūras mīksti «C» simboli. Kai pasārtīga 10 signāla toni ir «C» nustoka mīkstē, tārīkāja kārtīgās.

Ārējās signāla toni ir mīksti, kā arī tās ir gājās.

Lai 10. Šajās skānas signāliem atskānes, ja temperatūra ir zemāka par 37.5 °C ir gājās.

Nelietojiet tāpiji jūtīgus aprūpes nodalās, kur ieteicama augstāka līmena dezinfekcija (intensīvs terapijas nodala, onkoloģija...).

Biņķeļotās mērišanas rezultāti tiek parādīti displejā.

Biņķeļ